

Brugsanvisning 2

IM2-HEM-6181-E-DA-05-04/2022

Læs brugervejledningen 1 og 2 før brug.

1

Isætning af batterier

1

2

3

2

Indstilling af dato og klokkeslæt

1

2

3

4

5

6

3

Påsætning af håndledsmanchetten

1

2

3

4

4

Sæt dig korrekt

5

Foretag en måling

1

2

3

THIS WEEK

28/88

AVG AVG

288

288

188

SYS DIA

188

OK

7:23

78

82

7:23

73

OK

SYS ≥ 135 mmHg

DIA ≥ 85 mmHg

Brugsanvisning 1 1,3

Heart rate icon

Heart rate waveform



Person icon

Person illustration


Brugsanvisning 1 1,3



Visning af målinger i hukommelsen

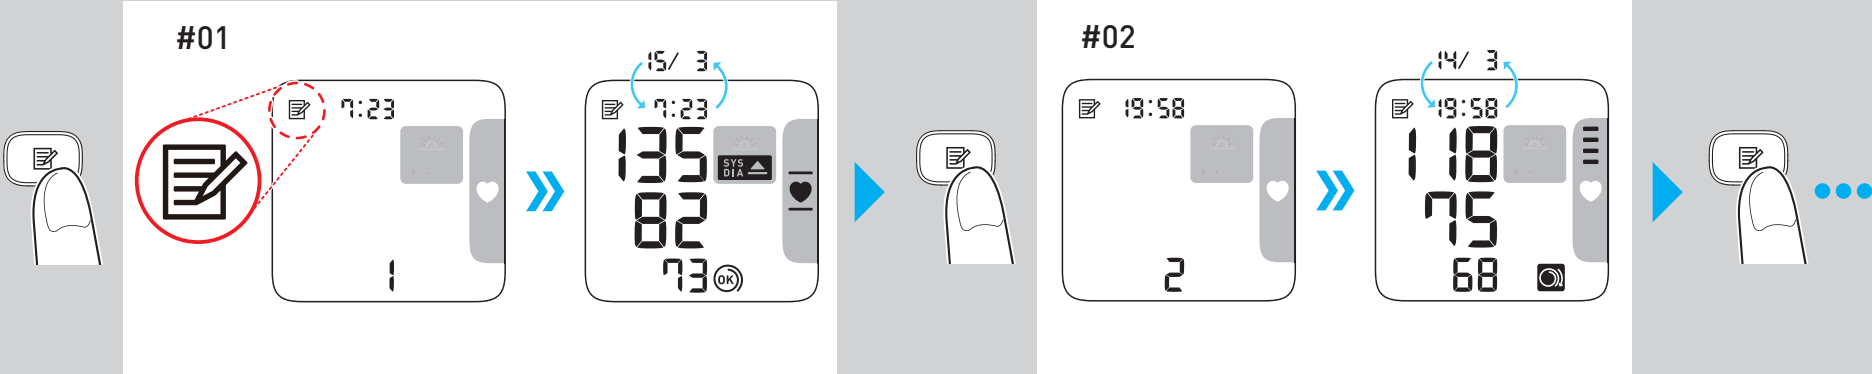

Sletter alle målinger i hukommelsen



Symbolbeskrivelse

	Patientdel - type BF: Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød (lækstrøm)		Temperaturbegrænsning
	Angiver apparatets korrekte placering på håndleddet. Målbar håndledsomkreds 13.5-21.5cm		Fugtighedsbegrænsning
IP XX	Indtrængningsbeskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529		Grænse for atmosfærisk tryk
CE	CE-mærkning		Læs brugervejledningen.
UK CA	UKCA-mærkning		Følg brugervejledningen omhyggeligt af hensyn til din sikkerhed
SN	Serie nr.		Batteri / søjle
UDI	Unik enhedsidentifikator		Jævnstrøm
MD	Medicinsk udstyr		Produktionsdato

Producent 		OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN	
EU-repræsentant EC REP		OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com	
Importør i EU			
Produktionsanlæg		OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam	
Datterselskaber		Importør i Storbritannien og ansvarlig person for Storbritannien	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors	
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	
Udstedelsesdato			2022-06-27