



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**SEDIA DA UFFICIO**  
**OFFICE CHAIR**  
**CHAISE DE BUREAU**  
**SILLA DE OFICINA**

---

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO  
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
MODE D'EMPLOI – INSTRUCTIONS ET MONTAGE  
MANUAL DE USO – INSTRUCCIONES Y MONTAJE



---


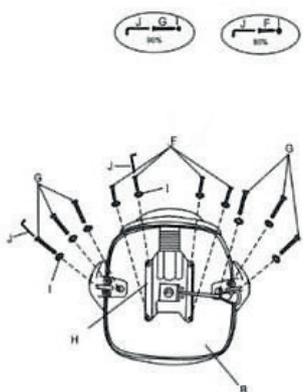

## GIMA 45110

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante:  
**Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**  
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,  
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China  
export@saikangmedical.com  
Made in China

**REF** SKE702

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importado por:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

**INSTALACIÓN**

		<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>A</p>  <p>1PC</p>	<p>B</p>  <p>1PC</p>	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>C</p>  <p>2PCS</p>	<p>D</p>  <p>1PC</p>	<p>E</p>  <p>5PCS</p>	<p>F</p>  <p>M6X20MM</p> <p>4PCS</p>
<p>G</p>  <p>M6X30MM</p> <p>6PCS</p>	<p>H</p>  <p>1PC</p>	<p>I</p>  <p>M6X15MM</p> <p>10PCS</p>	<p>J</p>  <p>1PC</p>
<p>K</p>  <p>1PC</p>	<p>L</p>  <p>1PC</p>	<p>M</p>  <p>1PC</p>	

**PESO MÁXIMO**

135 Kg

**EXCLUSIÓN DE AVERÍAS**

Averías comunes	Causas probables	Solutions
Es difícil mover toda la silla	1. La rueda se bloquea sin soltar el freno 2. La rueda está dañada	1. Suelte el freno 2. Cambie la rueda

**MANTENIMIENTO**

1. Para utilizar la silla segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas en la silla. Se recomienda revisarlo cada seis meses para comprobar si las conexiones no están sueltas y si todas las operaciones son normales.
2. Cuando el chasis se desgasta con el uso y llega a un determinado tiempo de servicio, la parte metálica y las partes de plástico se pueden reciclar.
3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulo agudo o cuchillos durante el uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
4. Si el panel se mancha accidentalmente, es conveniente limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar el carro de anestesia, ya que esto hará que la superficie de acero inoxidable se oxide.
5. Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, que causarán daños a las ruedas.
6. Está prohibido forzar el frenado de las ruedas al frenar, porque esto puede dañar el sistema de frenos.
7. El desgaste de la superficie de la rueda puede detectarse mediante una inspección visual. Es posible que algunos

hilos y otras acumulaciones se enrollen alrededor de la rueda; de ser así, retire los tornillos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.

8. Si se cambia la rueda en función del tiempo de uso y del desgaste, se pueden sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes están bien montados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarlo en este proceso.
9. En el caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar regularmente si estos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso.
10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda giratoria está dañado, y el freno necesita ser reparado o reemplazado, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa o distribuidor autorizado proporcionado por nuestra empresa. Cada vez que se sustituyen los frenos, se debe volver a probar el rendimiento de los frenos de las ruedas.

### **EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO**

1. El embalaje de la silla se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
2. Evite las prisas, las vibraciones violentas y evite la luz solar y la lluvia durante el transporte.
3. La silla debe ser almacenado:
  - a) Temperatura ambiente:  $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ .
  - b) Humedad relativa:  $\leq 85\%$ .
  - c) Presión atmosférica:  $70 \text{ kPa} \sim 106 \text{ kPa}$ .

### **SERVICIO POSTVENTA**

1. Por favor, guarde bien los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, y tiene que presentar estos archivos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si hay algún problema en el proceso de uso, por favor, póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo, para que nuestra empresa pueda proporcionarle un soporte técnico y servicios de mantenimiento precisos y rápidos de manera oportuna.
3. A partir de la fecha de venta, si el producto se rompe o se daña debido a la correcta instalación y uso según las especificaciones, el producto gozará de un año de garantía gratuita y servicio de mantenimiento de por vida con el "certificado" o factura.
4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto.
5. Servicio permanente del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD.

### **CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.