

**CALIBRO PER NEONATI**  
**BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS**  
**JAUGE POUR BÉBÉ**  
**CALIBRE PARA BEBÉS**  
**MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS**  
**MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE**  
**PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI**  
**KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN**  
**SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW**  
**ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do utilizador - Benutzerhandbuch -  
Manual de utilizare și întreținere - Instruktioner för användning och underhåll  
Instrukcja użytkownika - Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

**CUIDADO:** Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

**VORSICHT:** Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

**ATENȚIE:** Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

**FÖRSIKTIGHET:** Operatörer måste läsa och förstå denna manual helt innan de använder produkten.

**UWAGA:** Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος.

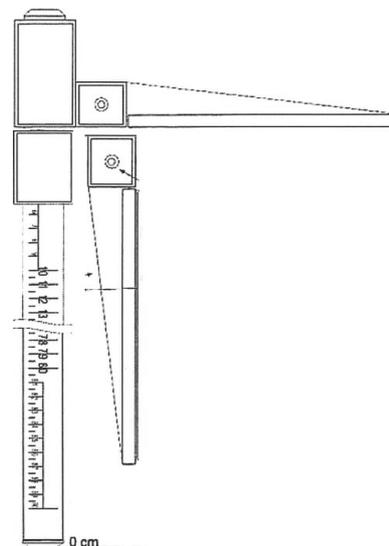
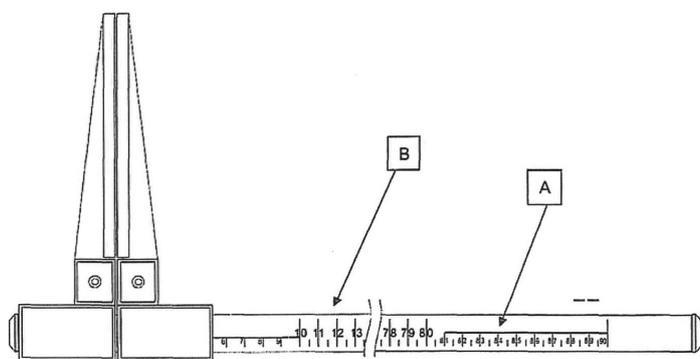
**GIMA 27326**

Metrica S.p.A.,  
Via A. Grandi 18, 20097  
San Donato Milanese (MI) - Italy  
Made in Italy

**10455**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**0425**


**ITALIANO**
**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

**PREMESSA**

Lo scopo di questo manuale è quello di fornire al cliente tutte le indicazioni possibili sul CALIBRO PER NEONATI, nonché le istruzioni d'uso e di manutenzione che permettono di mantenere nel tempo sia le prestazioni che l'efficienza del CALIBRO PER NEONATI.

Il manuale d'uso deve essere conservato in buono stato e riposto in luogo accessibile per una rapida consultazione.

**DESTINAZIONE D'USO**

Il CALIBRO PER NEONATI è uno strumento che ha la funzione di misurare in cm, con una precisione di  $\pm 1$  cm, la lunghezza del corpo di un neonato, o di parti del suo corpo.

**ISTRUZIONI D'USO**

Avvicinare i due becchi del calibro alla parte del corpo da misurare e leggere il valore indicato dall'indice sulla scala graduata.

Il dispositivo dispone di asta graduata con due tipi di scala per la misura: in cm

A) la scala con carattere più piccolo da 0-90 cm passo 0,5 cm – tolleranza  $\pm 0,5$  cm

B) la scala più grande da 0-90 cm passo 0,5 cm – tolleranza  $\pm 0,5$  cm

Può essere utilizzato anche in verticale orientando di  $90^\circ$  il becco interno portandolo contro l'asta graduata

**AVVERTENZE/MANUTENZIONE**

Il CALIBRO PER NEONATI deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato.

Non usare il dispositivo in caso di danneggiamento. Evitare di effettuare riparazioni per conto proprio, in caso di necessità rivolgersi al fabbricante. Dopo aver aperto la confezione, controllare tutti i pezzi e le parti che compongono il prodotto. Verificare che siano tutti presenti e in perfette condizioni. La pulizia del CALIBRO PER NEONATI deve essere effettuata con un panno umido di sostanze che non rovinino l'alluminio, come ad esempio alcool a/o detergente per vetri. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. Il CALIBRO è stato concepito per durare nel tempo: è resistente alla maggior parte dei prodotti chimici, ad eccezione dei metiletilchetoni (M.E.K.), diluenti e solventi per unghie.

Il CALIBRO deve essere conservato sempre nella sua custodia in un ambiente non umido.

**DESCRIZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO**

N. Particolare	Descrizione pezzo
1	Becchi
2	Supporto mobile
3	Supporto fisso
4	Asta in alluminio graduata
5	Tappo plastica di chiusura

Per la sostituzione dai componenti si deve spedire lo strumento presso il fabbricante.

REF	Codice prodotto	LOT	Numero di lotto
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Dispositivo medico		Data di fabbricazione
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Leggere le istruzioni per l'uso
	Numero di serie		Distribuito da
	Identificatore univoco del dispositivo		