



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

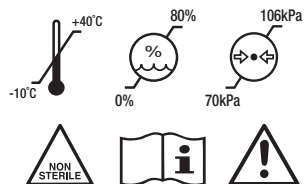

Uso previsto:

- Questo prodotto funziona in base alla regolazione della posizione della fibbia sulla cintura per fissare il trasduttore fetale.

Introduzione al prodotto:

- Nome del prodotto: Cintura riutilizzabile con trasduttore fetale
- Struttura del prodotto: È composto da una cintura elastica e da una fibbia.

Gamma di prodotti:

- Viene utilizzato con il trasduttore fetale in gravidanza nel monitoraggio fetale, per fissare il trasduttore fetale.

Condizione d'uso:

- Temperatura: 0°C~40°C
- Umidità relativa: 15%~95%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

Confezione e conservazione:

- La cintura fetale deve essere confezionata in un unico imballaggio; il prodotto confezionato deve essere conservato in un locale non corrosivo e con una buona ventilazione.

Conservare l'ambiente come indicato di seguito:

- Temperatura: -10°C~+40°C
- Umidità relativa: ≤80%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

Installazione/utilizzo:

- Fissare un'estremità della cintura al trasduttore inserendo uno dei fori della cintura sul pulsante in cima al trasduttore.
- Mantenendo il trasduttore in posizione, tendere l'altra estremità della cintura e agganciarla al

pulsante, assicurando una tensione sufficiente a mantenere il trasduttore in contatto con l'addome.

- Evitare di stringere eccessivamente per non creare inutili disagi al paziente.

Prodotto pulito:

- Lavare la cintura in acqua tiepida, non strofinare il bordo della cintura fetale per evitare la rimozione, non esporla.

Periodo di validità:

- Periodo di validità: 2 anni.

Sostituire e abbandonare:

- Sostituire: In queste situazioni, come fratture, danni elastici, data di scadenza, sostituire la cintura fetale con una nuova.
- Abbandono: Il nastro abbandonato può essere trattato come un normale rifiuto.

Controindicazioni, precauzioni, avvertenze e consigli di prudenza:

- Controindicazioni: Le cinture non devono essere fissate nel punto della lesione.
- Allergie allo spandex da smettere di usare.
- Leggere le istruzioni prima dell'uso.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

