



1 Baterijų įdėjimas

Naudojimo instrukcija **2** IM2-HEM-6181-E-LT-05-04/2022




Prieš naudodami, perskaitykite naudojimo instrukciją **1** ir **2**.



All for Healthcare


2 Datos ir laiko nustatymas




3 Riešo rankovės uždėjimas



4 Tinkamas sėdėjimas





5 Matavimas






Atmintyje išsaugotų rodmenų peržiūra

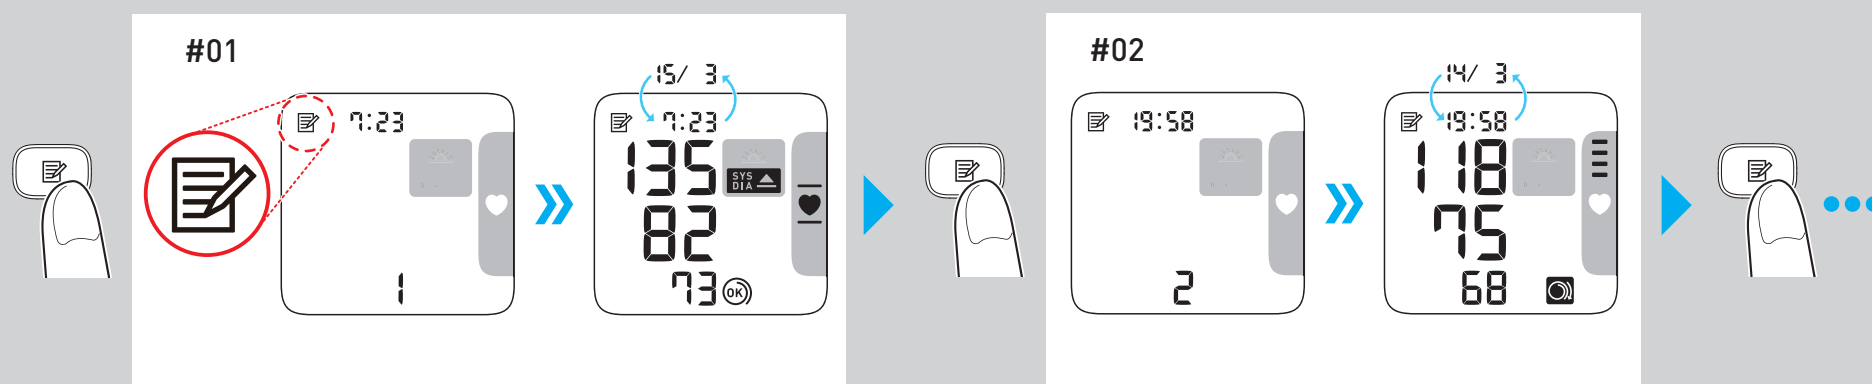

Visų atmintyje išsaugotų rodmenų pašalinimas



Simbolių aprašai

	Su pacientu besiliečianti dalis. BF tipo. Apsaugos nuo elektros šoko (nuotėkio srovės) laipsnis		Temperatūros apribojimas
	Rodo tinkamą matuoklio padėtį ant riešo. Išmatuojama riešo apimtis 13,5-21,5cm		Drėgnio apribojimas
IP XX	Apsaugos nuo įsiskverbimo laipsnis, numatytas IEC 60529		Atmosferos slėgio apribojimas
CE	CE žymėjimas		Naudotojas turi žiūrėti šią naudojimo instrukciją
UK CA	UKCA ženklinimas		Dėl savo paties saugumo naudotojas turi atidžiai vadovautis šia naudojimo instrukcija
SN	Serijos numeris		Baterija / el. baterija
UDI	Unikalūs prietaiso identifikatoriai		Tiesioginė srovė
MD	Medicinos prietaisas		Pagaminimo data

Gamintojas		OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONIJA
Atstovybė ES šalyse		OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NYDERLANDAI www.omron-healthcare.com
Importuotojas ES		
Gamybos įmonė		OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Dukterinės bendrovės	Importuotojas Jungtinėje Karalystėje ir JK atsakingasis asmuo	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Išleidimo data		2022-06-27