



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI NEFERTITI ELECTRIC CHAIR

Manuale d'uso - User's manual



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

REF 28045

Importato da/imported by/importé de/importado de:
GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in China

CE



1. AVVERTENZE

Scollegare il prodotto dall'alimentazione durante la sostituzione di componenti elettrici o durante le procedure di manutenzione e pulizia. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra, per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche.

Non mettersi in piedi su questo apparecchio.

Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio e posizionarlo al di fuori della loro portata; Si prega di regolare lo schienale nella posizione più alta quando non viene utilizzato. Non posizionare il lettino in luoghi umidi, come una stanza da bagno, per evitare scosse elettriche o guasti di altro genere. Evitare inoltre di fare entrare il telecomando in contatto con liquidi. Non posizionare l'apparecchio in luoghi dove si effettuano procedure di verniciatura/rivestimento o erogazione di ossigeno durante il suo funzionamento.

I bambini e le persone che hanno impedimenti fisici, disturbi tattili, disturbi mentali, esperienza o senso comune insufficiente, sono autorizzati ad utilizzare l'apparecchio soltanto previo addestramento o sotto la sorveglianza di personale che sia ritenuto responsabile della loro sicurezza personale.


Si prega di contattare il distributore, il centro assistenza o personale dotato di competenza ed esperienza adeguate per effettuare le riparazioni in caso di spina danneggiata o in caso di pericolo.

Assicurarsi che non vi sia alcun oggetto accessibile lungo il tragitto, durante qualsiasi operazione del lettino. La manutenzione deve essere eseguita da professionisti qualificati.

2. PRECAUZIONI


Leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione, al funzionamento e alla regolazione del prodotto. Mantenere il prodotto in buone condizioni. Il lettino è dotato di cavo di alimentazione a tre fili. Il cavo di alimentazione deve essere inserito in una presa a tre fori che sia correttamente installata e messa a terra. Ciò non solo previene il rischio di scosse elettriche, ma assicura anche il corretto funzionamento del lettino. Durante la regolazione dello schienale, del cuscino del sedile, del poggiatesta o quando si solleva l'intero lettino mediante il comando manuale o il comando a pedale, si prega di tenere mani, piedi e testa lontani dalle posizioni 1.2.3.4.5.6.7 mostrate nella foto sottostante per evitare di rimanere incastrati. Quando si solleva l'intero lettino, il pulsante deve essere premuto continuamente fino a quando il lettino non si trova in posizione appropriata.

Si prega di fare attenzione a che la frequenza di ingresso sia $M_s \times 6 \text{ min/h}$ quando si mette in funzione il motore. La manutenzione deve essere eseguita da professionisti qualificati. Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle del lettino o sul coperchio di plastica. Gima non può essere considerata responsabile in caso di uso improprio del prodotto.

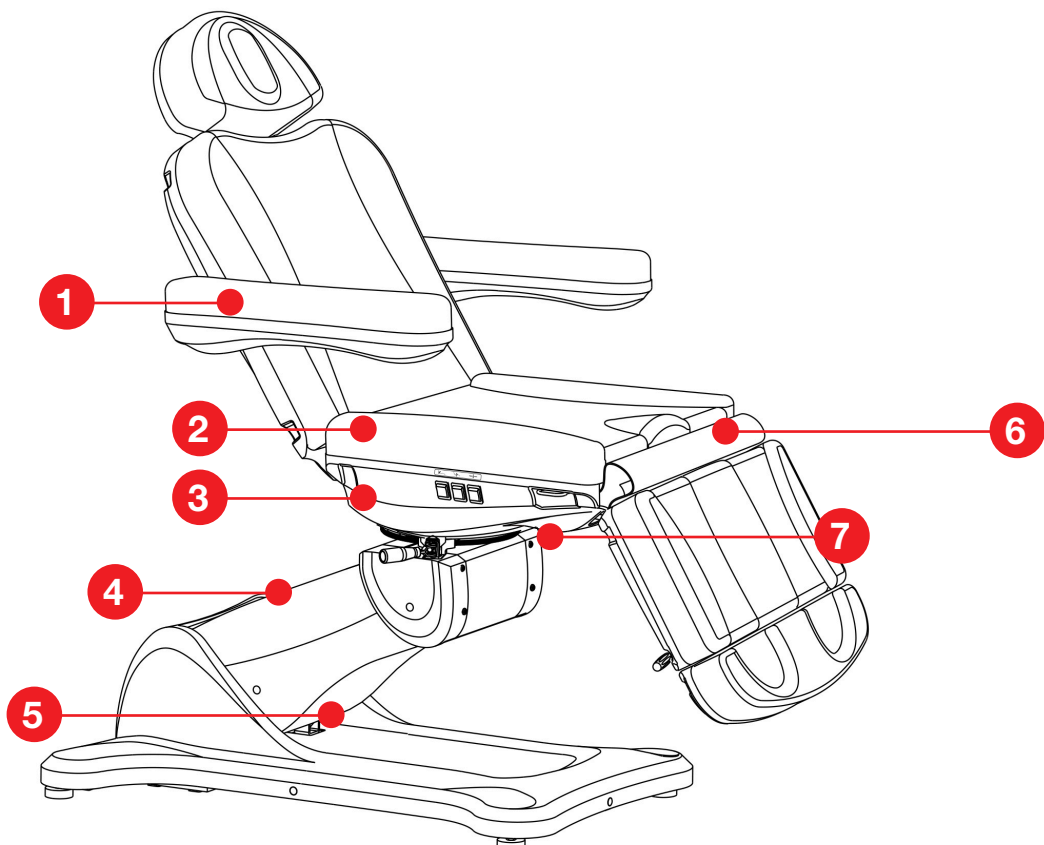

3. STRUTTURA

Questo lettino è composto dalla centralina, dal motore, dall'hardware, da parti in plastica e pelle. Tra questi, la centralina controlla il funzionamento di tre motori e il comando manuale. Questo lettino è in grado di regolare l'angolazione dello schienale, l'angolazione del cuscino del sedile e di gestire il sollevamento dell'intero lettino, in quanto dispositivo integrale. (vedere l'immagine qui sotto)

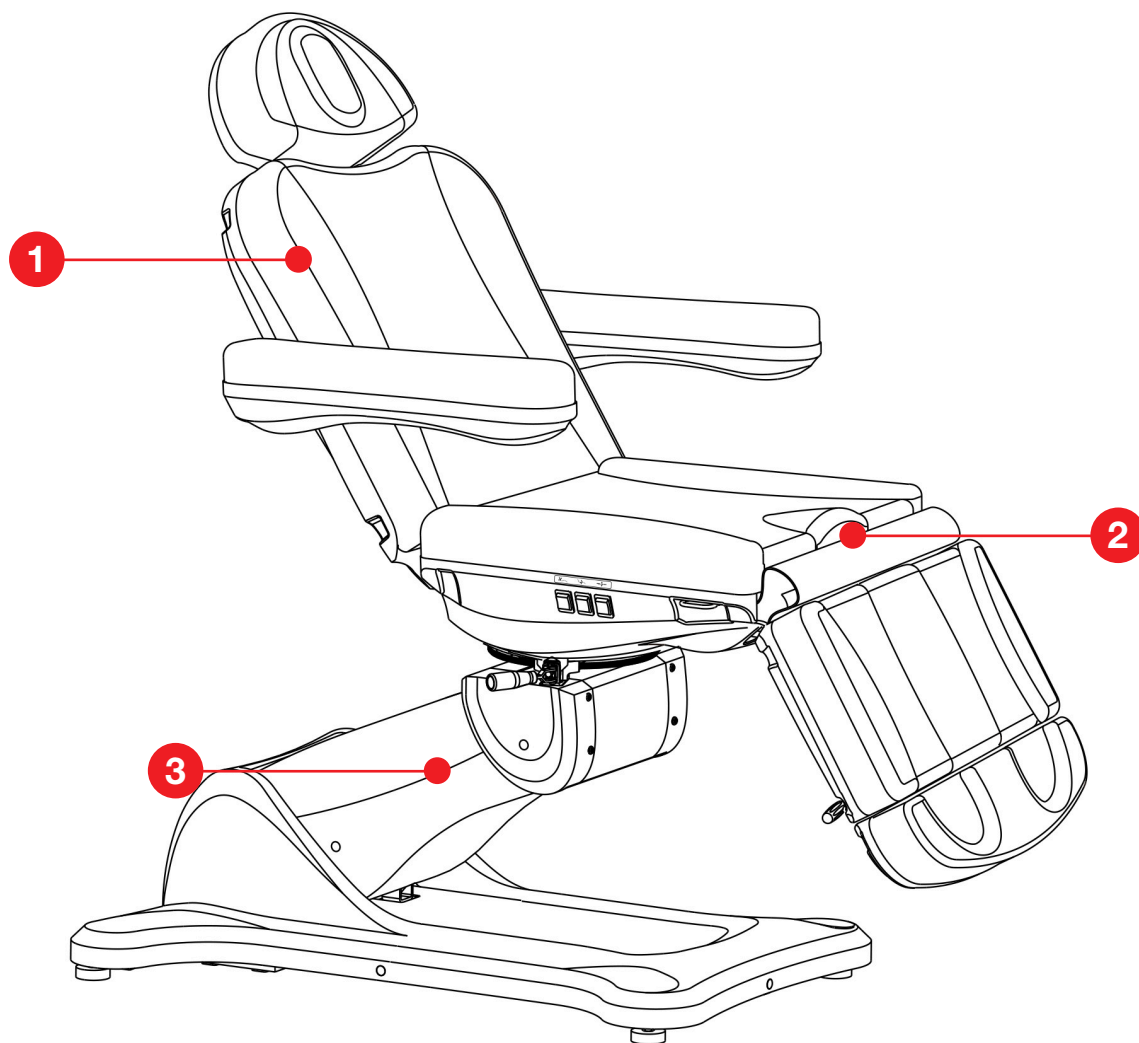



1. Regolazione dell'angolazione dello schienale.
2. Regolazione dell'angolazione del cuscino del sedile.
3. Regolazione del sollevamento dell'intero lettino.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Adatto a trattamenti medici, estetici e massaggi.



5. INSTALLAZIONE

1. Collocare il lettino in una posizione appropriata, tenendo conto della disposizione generale, della luce solare o delle luci artificiali e delle condizioni operative del salone o dell'abitazione. Mantenere un ambiente operativo pulito, asciutto e fresco.
2. Aprire l'imballaggio e verificare l'integrità del lettino e la presenza di ogni accessorio o parte di ricambio. Si prega di contattare il distributore o il produttore per qualsiasi tipo di problema.
3. Installazione: Posizionare il lettino nella posizione corretta. Si prega di notare che non è necessario installare alcuna vite supplementare sul pavimento per fissare il lettino, in quanto il design originale ha preso in considerazione le prestazioni di stabilità. Assicurarsi però che il lettino sia posto su una superficie piana e solida, in modo da evitare qualsiasi incidente. Se il lettino tende a ruotare o inclinarsi a causa della superficie accidentata, è possibile regolare le quattro parti dei piedini in plastica (M10x30) e i dadi (M10) mediante una chiave esagonale, fissandoli sul pannello inferiore, in modo da garantire la stabilità del lettino.
4. Alimentazione: La tensione e la frequenza in ingresso devono essere CA 100-120, 50/60 Hz o 220-240 V, 50/60 Hz. Collegare correttamente il lettino all'alimentazione. (vedere l'immagine qui sotto)

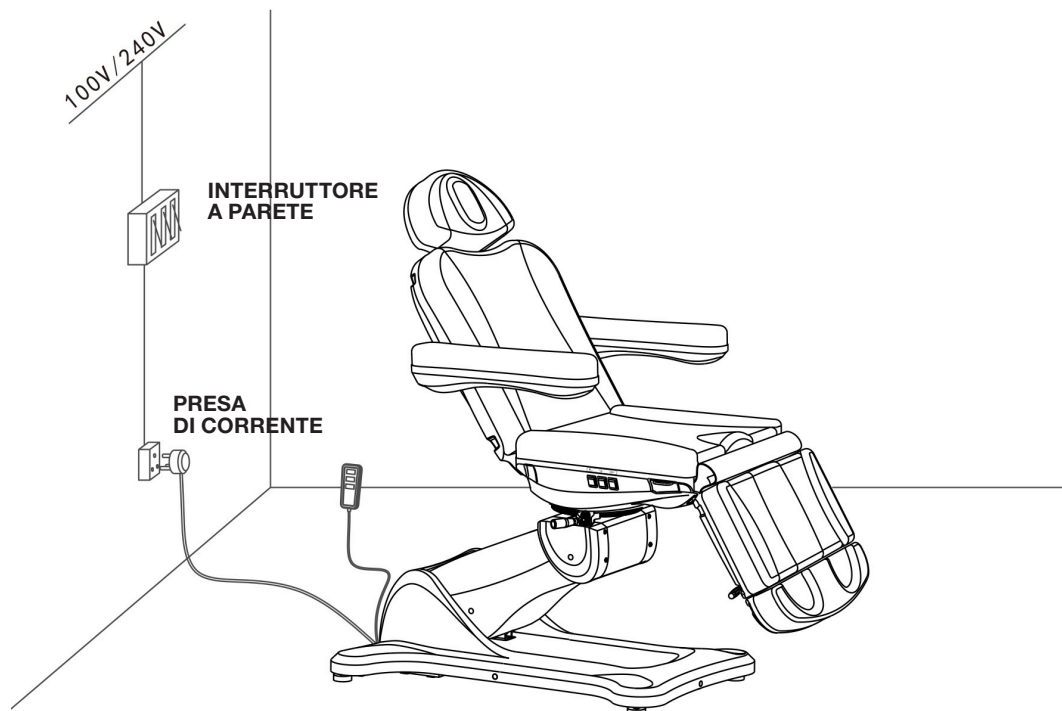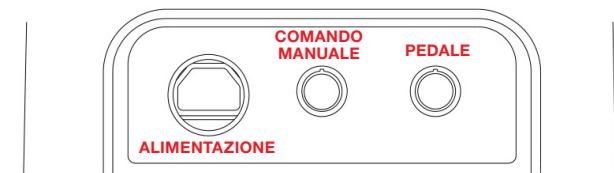


6. ISTRUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Configurazione standard (interruttore a bilanciere)

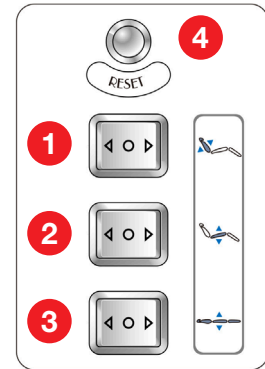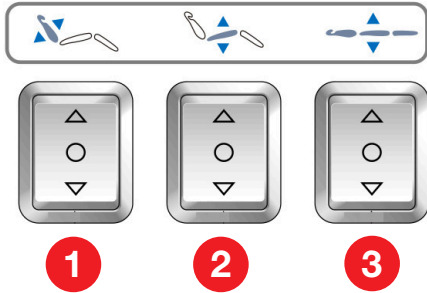


Descrizione	Funzionamento
1. Pulsante del motore dello schienale.	Il pulsante consente di alzare o abbassare dolcemente lo schienale.
2. Pulsante del motore dell'angolazione del cuscino.	Consente di aumentare o diminuire l'angolazione del cuscino.
3. Pulsante del motore dell'intero lettino.	Consente di alzare o abbassare dolcemente l'intero lettino.
4. Pulsante di reset.	Premendo il pulsante, lo schienale e il cuscino verranno automaticamente portati al livello di massima angolazione, e l'altezza del lettino verrà portata nella posizione più bassa consentita.

Configurazione opzionale (Comando manuale)

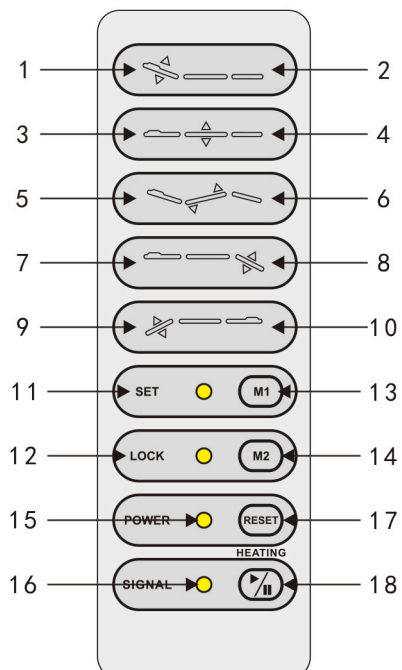

Configurazione opzionale (Comando a pedale)

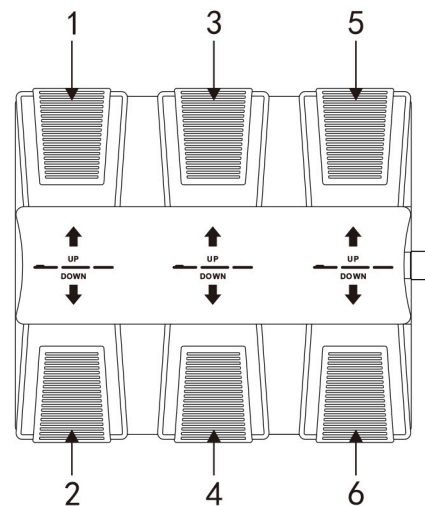


	Descrizione	Funzionamento
1	Il motore dello schienale va su	Lo schienale si alza dolcemente premendo il pulsante.
2	Il motore dello schienale va giù	Lo schienale si abbassa dolcemente premendo il pulsante.
3	Il motore dell'intero lettino va su	L'intero lettino si alza dolcemente premendo il pulsante.
4	Il motore dell'intero lettino va giù	L'intero lettino si abbassa dolcemente premendo il pulsante.
5	Il motore dell'angolazione del cuscino va su	L'angolazione del cuscino aumenta dolcemente premendo il pulsante.
6	Il motore dell'angolazione del cuscino va giù	L'angolazione del cuscino diminuisce dolcemente premendo il pulsante.
7	L'imbottitura della gamba destra va su	L'angolazione dell'imbottitura della gamba destra aumenta dolcemente premendo il pulsante.
8	L'imbottitura della gamba destra va giù	L'angolazione dell'imbottitura della gamba destra diminuisce dolcemente premendo il pulsante.
9	L'imbottitura della gamba sinistra va su	L'angolazione dell'imbottitura della gamba sinistra aumenta dolcemente premendo il pulsante.
10	L'imbottitura della gamba sinistra va giù	L'angolazione dell'imbottitura della gamba sinistra diminuisce dolcemente premendo il pulsante.
11	Inserire l'impostazione di memoria della posizione	La luce di indicazione si accende premendo il pulsante per 3 secondi, quindi è possibile inserire l'impostazione di memoria della posizione perché sia memorizzata.
12	Indicazione del blocco dei pulsanti	La luce di indicazione si accende premendo il pulsante per 3 secondi, quindi ogni altro pulsante risulta bloccato; per sbloccare nuovamente i pulsanti, tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
13	Impostazione di memoria della posizione 1	1. Dopo l'accesso all'impostazione di memoria della posizione, l'indicatore dell'impostazione di memoria della posizione si accende. Selezionare le impostazioni che si desidera salvare, quindi premere il pulsante per memorizzarle. L'indicatore si spegne una volta usciti dall'impostazione di memoria della posizione. 2. Premere il pulsante affinché il lettino si porti automaticamente nella posizione memorizzata.
14	Impostazione di memoria della posizione 2	1. Dopo l'accesso all'impostazione di memoria della posizione, l'indicatore dell'impostazione di memoria della posizione si accende. Selezionare le impostazioni che si desidera salvare, quindi premere il pulsante per memorizzarle. L'indicatore si spegne una volta usciti dall'impostazione di memoria della posizione. 2. Premere il pulsante affinché il lettino si porti automaticamente nella posizione memorizzata.
15	Indicatore dell'alimentazione	L'indicatore sarà acceso se il comando manuale è correttamente collegato all'alimentazione. In caso contrario sarà spento.
16	Indicatore della funzione di riscaldamento (opzionale)	Premere il pulsante per attivare o disattivare la funzione di riscaldamento.
17	Reset del motore	Premendo il pulsante, lo schienale e il cuscino verranno automaticamente portati al livello di massima angolazione, l'imbottitura delle gambe raggiungerà l'angolazione minima, e l'altezza del lettino verrà portata nella posizione più bassa consentita.
18	Riscaldamento (opzionale)	Premere il pulsante per attivare o disattivare la funzione di riscaldamento.

Note: L'impostazione di memoria della posizione è disponibile soltanto per i modelli con funzione di memorizzazione. La funzione di riscaldamento è disponibile solo per i modelli con funzione di riscaldamento.


7. PARAMETRI TECNICI

Dimensioni del prodotto	1860 (Lungh.) × 860 (Largh.) × 580 (880) (H) mm
Dimensione dell'imballaggio	1360 x 820 x 640 mm
La posizione più alta	880±10 mm
La posizione più bassa	580±10 mm
Regolazione dell'angolazione dello schienale	0°~+80°
Regolazione dell'angolazione del cuscino del sedile	0°~+10°
Rotazione dell'angolazione a destra e sinistra	-120°~+120°
Regolazione dell'angolazione del poggiatesta	-90°~0°
Regolazione della lunghezza del poggiatesta	150 mm
Peso netto	79 kg
Peso lordo	92 kg
Alimentazione	CA 220~240 V, 50 Hz/60 Hz
Potenza massima	300W
Temperatura ambiente	0°C~+40°C
Umidità relativa	30%~90%
Carico nominale di sollevamento	170 kg

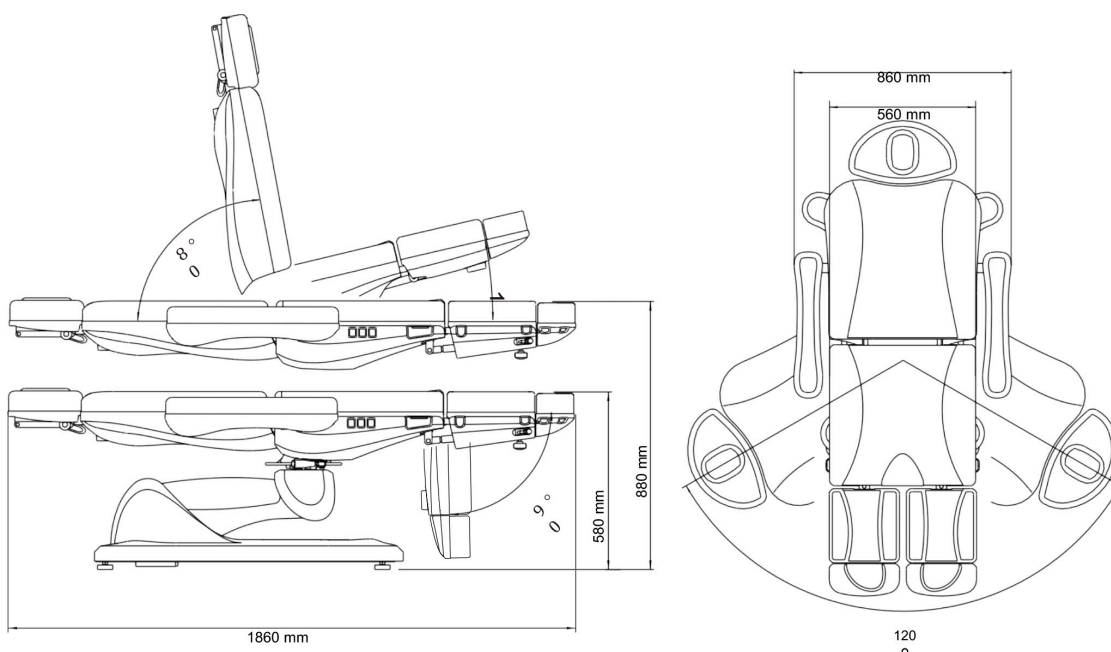

8. SCHEMA DELLE CONNESSIONI DEL CIRCUITO

AC 100-120V ,50Hz/60Hz OR AC 220-240V,50Hz/60Hz

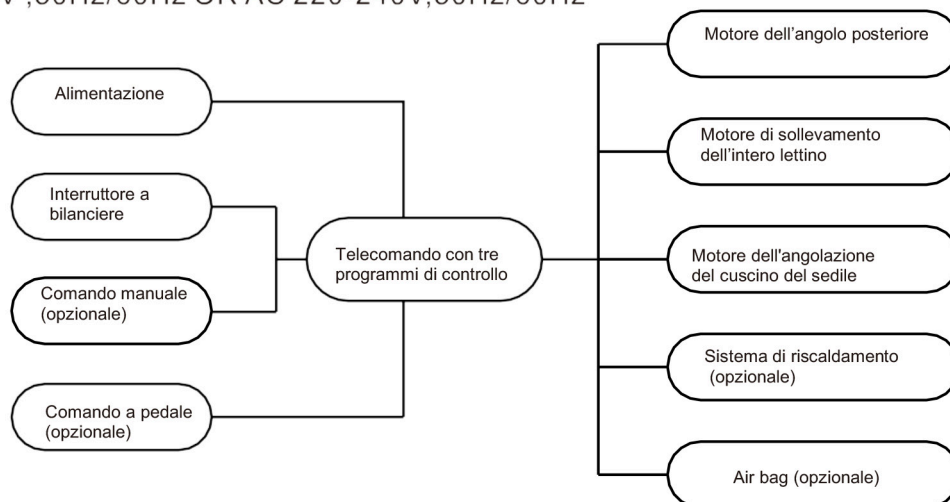

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Problema o guasto	Motivo	Soluzione
Non si alza o abbassa normalmente	1. Il cavo dell'alimentazione è scollegato o non collegato correttamente	1. Collegare il cavo di alimentazione o ricollegarlo correttamente
	2. Cattivo funzionamento del comando manuale	2. Sostituire il pannello di controllo manuale
	3. Cattivo funzionamento dell'interruttore del comando a pedale	3. Se il problema persiste dopo aver sostituito il comando manuale o l'interruttore del comando a pedale, contattare il centro assistenza e manutenzione o il fornitore per risolvere il problema.
	4. Cattivo funzionamento della scatola di controllo	
	5. Rottura della coda del motore	
	6. Battito in testa del motore	1. Se è presente un suono "Di" ma il pulsante reset non funziona, allentare il poggiatesta, richiuderlo completamente e fissarlo accuratamente. Quindi, riprovare con la funzione reset. 2. Se il pulsante reset non funziona e non è presente un suono "Di", aprire separatamente le coperture di plastica del poggiatesta e dello schienale e controllare se i terminali delle linee di alimentazione sono scollegati. In caso affermativo, collegarle e riprovare con la funzione reset. 3. Se il problema persiste anche dopo aver eseguito le procedure sopra descritte, si prega di contattare il centro assistenza e manutenzione o il fornitore per risolvere il problema.
	7. Se la funzione reset non funziona	
Suono anomalo	1. Mancanza di olio lubrificante nelle parti rotanti	1. Aggiungere olio lubrificante
	2. Posizione di rotazione (cardine, impostazioni P, O, M) Mancanza di olio lubrificante	2. Aggiungere olio lubrificante
	3. Problemi di qualità del motore	3. Sostituire il motore

10. MANUTENZIONE

Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle del lettino o sul coperchio di plastica. Ciò serve a prevenire l'invecchiamento precoce della copertura in pelle e plastica

ISTRUZIONI PER IL SERRAGGIO DEL BLOCCO FRENANTE SULLA SERIE 2246

Per stringere il blocco frenante il cui l'ingranaggio è usurato.

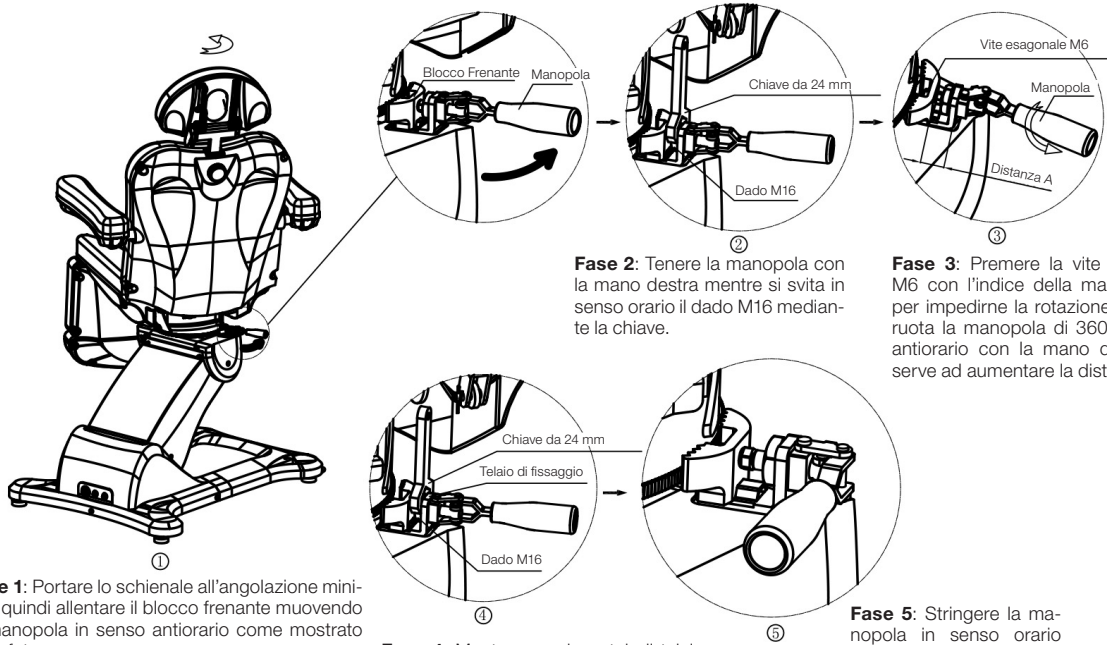

Fase 1: Portare lo schienale all'angolazione minima, quindi allentare il blocco frenante muovendo la manopola in senso antiorario come mostrato nella foto sopra.

Fase 4: Mantenere orizzontale il telaio di fissaggio tenendo la manopola con la mano destra, mentre si avvitava in senso antiorario il dado M16 con la chiave mostrata nella foto sopra.


Fase 2: Tenere la manopola con la mano destra mentre si svita in senso orario il dado M16 mediante la chiave.

Fase 3: Premere la vite esagonale M6 con l'indice della mano sinistra per impedirne la rotazione mentre si ruota la manopola di 360° in senso antiorario con la mano destra. Ciò serve ad aumentare la distanza A.

Fase 5: Stringere la manopola in senso orario come mostrato nella foto sopra.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL BLOCCO FRENANTE SULLA SERIE 2246

Per sostituire il blocco frenante se il suo ingranaggio è completamente usurato e non più in grado di funzionare.

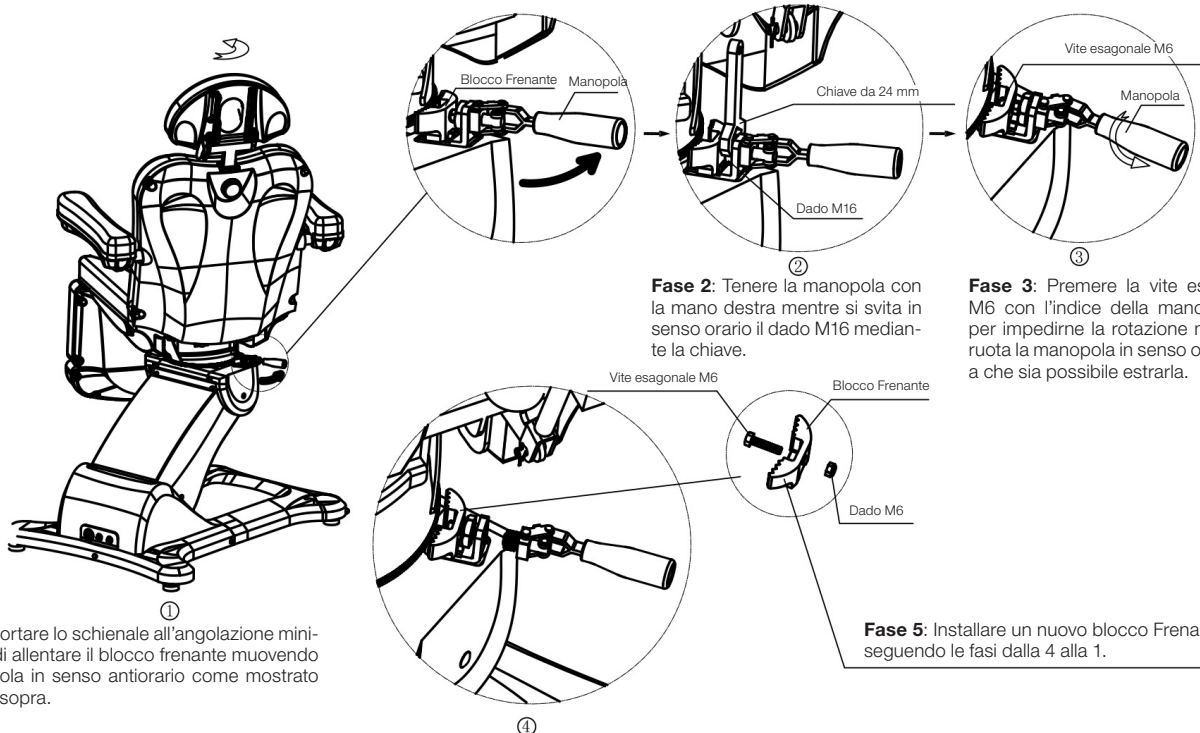

Fase 1: Portare lo schienale all'angolazione minima, quindi allentare il blocco frenante muovendo la manopola in senso antiorario come mostrato nella foto sopra.

Fase 4: Rimuovere il blocco frenante, quindi serrare la vite esagonale con la chiave mentre si svita il dado M6 mediante un'altra chiave.

Fase 2: Tenere la manopola con la mano destra mentre si svita in senso orario il dado M16 mediante la chiave.

Fase 3: Premere la vite esagonale M6 con l'indice della mano sinistra per impedirne la rotazione mentre si ruota la manopola in senso orario fino a che sia possibile estrarla.

Fase 5: Installare un nuovo blocco Frenante seguendo le fasi dalla 4 alla 1.

1. WARNING

Power supply must be cut off when changing electrical components or maintaining and cleaning machines.

The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded, to prevent the risk of fire and electric shock.

Do not stand on this equipment. Do not allow children to play with and place the equipment in a place where children can avoid touching. Please adjust the backrest back to the highest position when you leave.

Please do not place the equipment in damp places such as bathroom to avoid electric shock or other failure; The remote control should also avoid contact with water. Please do not place the equipment in places where painting/coating or oxygen providing during operation.

Unless being monitored or instructed by personnel who can be responsible for their personal safety, the people who have physical obstacles, tactile disorders, mental disorders, lacking of experience, common sense or children, are not allow to use the equipment.

Please contact distributor, service center or related personal with appropriate skill and experience for repairing if the plug is damaged, in case of any dangerous. Please make sure there is no accessible thing within the stroke during any operation of the beds. Maintenance should be processed by trained professionals.

2. PRECAUTIONS


Read this manual carefully before installation, operation and adjustment. And please keep it well. This Electric beauty bed is equipped with a three-wire power cord. The power cord must be plugged into an three-hole outlet which is properly installed and grounded. This is not only to prevent the risk of electric shock, but also ensure bed work properly.

When adjusting the backrest, seat cushion, footrest or lifting of the whole bed by manual controller or foot control switch, please keep your hands, feet and head away from the position 1.2.3.4.5.6.7 showed on below photo to avoid getting jammed.

While controlling the lifting of the whole bed, the button must be pressed continuously until the bed be in a suitable position.

Please pay attention that the input frequency should be $M_s \times 6\text{min/h}$ when operating the motor. Maintenance should be processed by trained professionals. After each treatment, please use neutral reagent to clear the dust, stains on leather or on plastic cover.


Gima cannot be held responsible in case of improper use of the product.

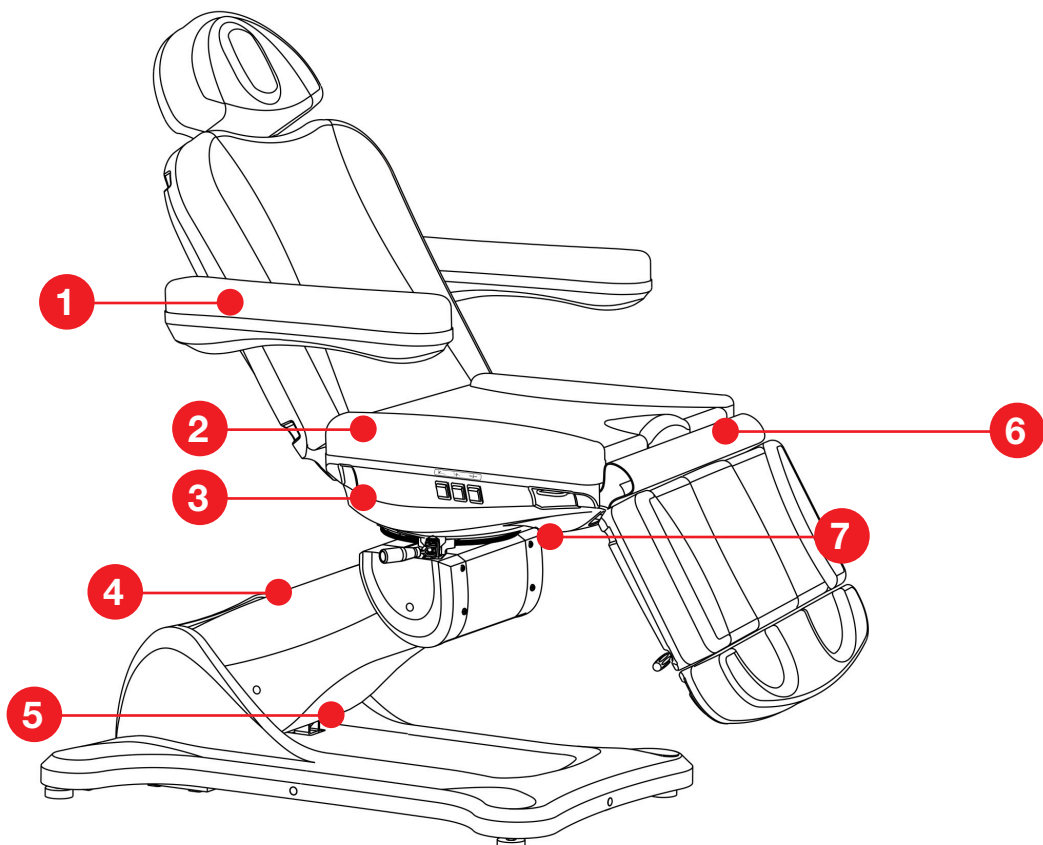

3. STRUCTURE

This beauty bed consists of controller box, motor, hardware, plastic parts and leather. Among them, the controller box is controlling the operation of three motors and the hand controller.

This beauty bed includes angel adjustment of the backrest, angel adjustment of the seat cushion and lifting adjustment of the whole bed which is an overall and integral structure. (Details as shown below)

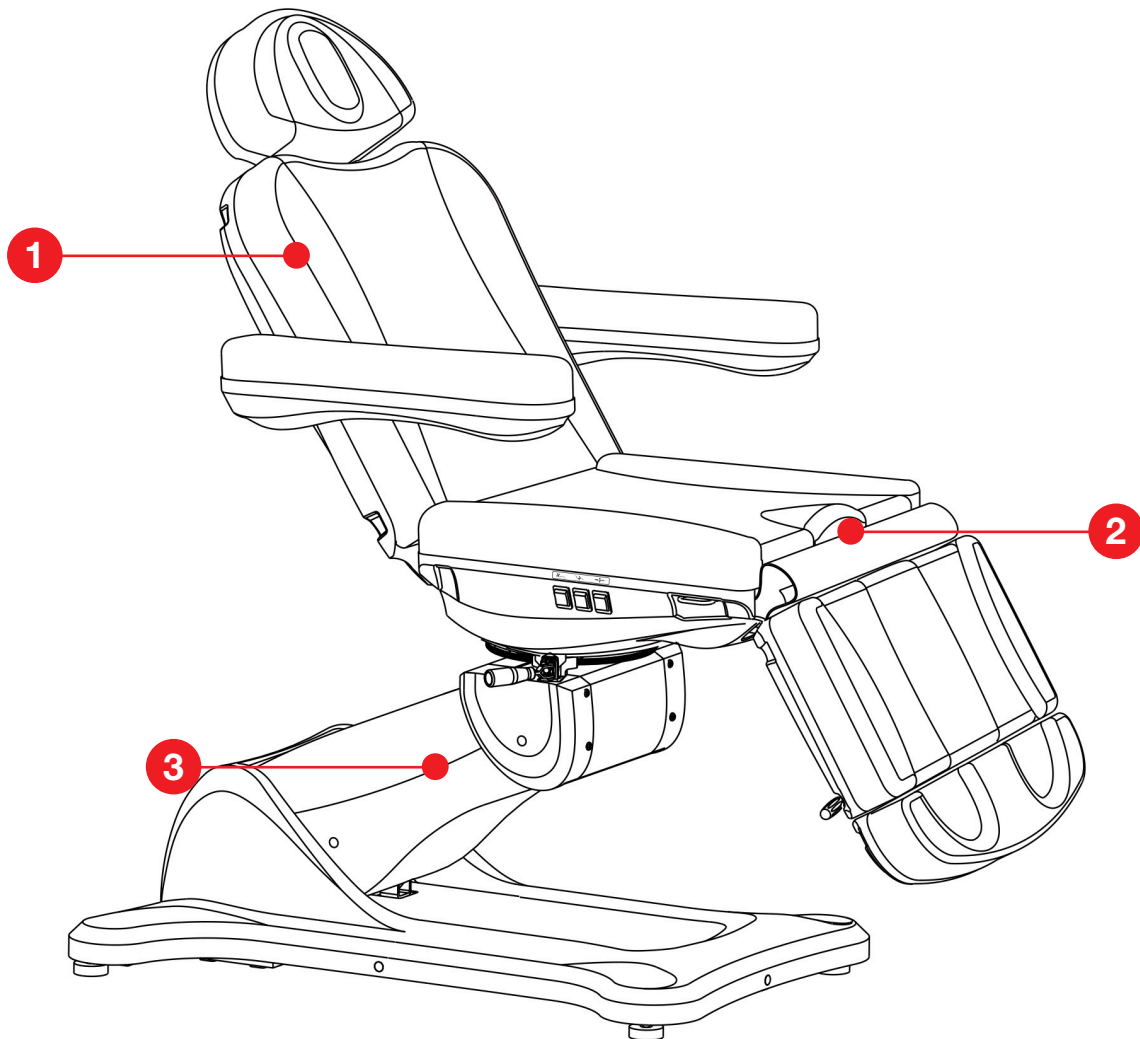



1. Angel adjustment of the backrest .
2. Angel adjustment of the seat cushion.
3. Lifting adjustment of the whole bed.

4. SERVICEABLE RANGE

This electric beauty bed is suitable for beauty and massage treatment..



5. INSTALLATION

1. Put the bed to a proper location, according to the overall layout, the daylighting or artificial lightings and operation condition of the salon's or the home. And keep it in the clean, dry and cool operating environment.
2. Open the Packing Carton to Check Open the packing carton, check if the bed is intact and whether the accessories or spares are complete. Please contact distributor or us if there's any problem.
3. Installation: Place the bed to the proper position. Please note that it is unnecessary to install extra screw on the floor to fasten the bed, because the original design has take the stability performance into consideration. But please ensure the bed is placed on a firm and flat ground, so as to prevent any accident. If the bed rotates or slant due to rough ground, you could adjust the four pieces of plastic feet (M10×30) and nuts (M10) by hexagon open-end wrench, which are fasten on the bottom panel, so as to ensure the bed is stable.
4. Power input: Voltage and frequency input shall be AC 100-120, 50/60Hz or 220-240V, 50/60Hz. Plug the bed on the power supply properly. (Details as shown below)

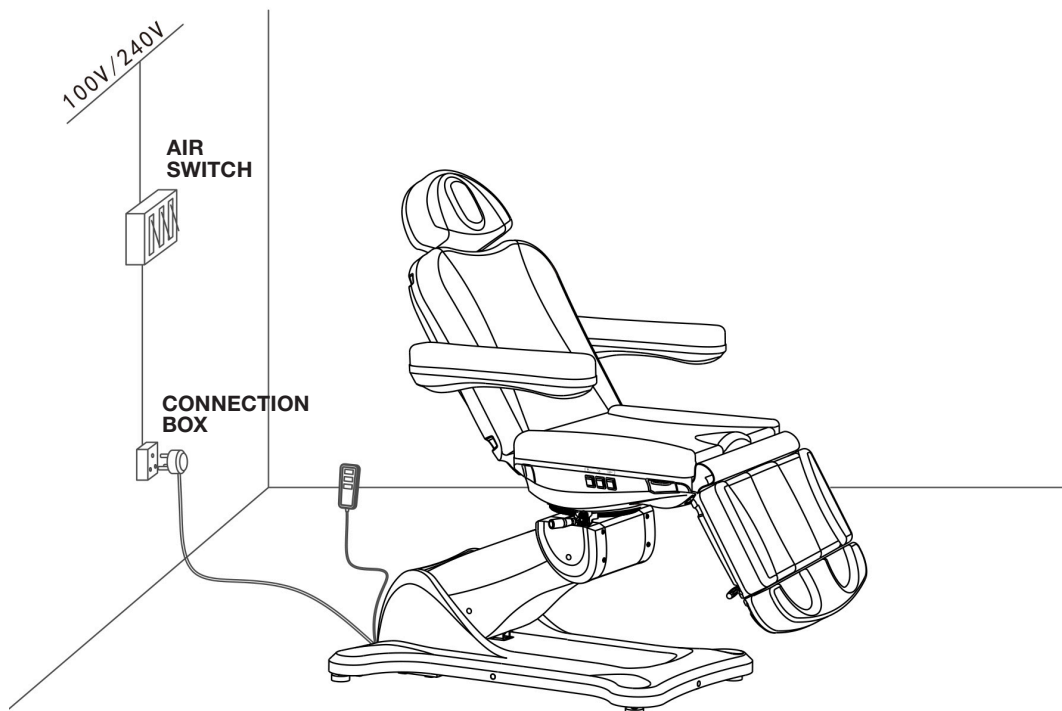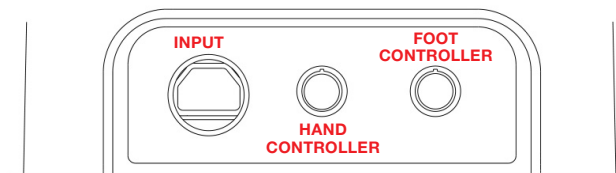


6. OPERATION INSTRUCTION

1. Standard configuration (Rocket Switch)

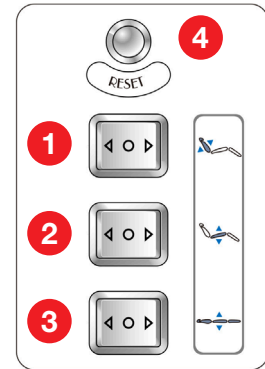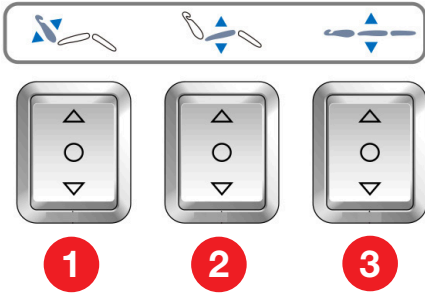


Description	Operation
1. Backrest motor button.	Backrest goes up (goes down) smoothly by pressing the button.
2. Cushion angle motor button.	Angle of cushion increases (decreases) smoothly by pressing the button.
3. Whole bed motor button.	The whole bed goes up (goes down) smoothly by pressing the button.
4. One-key reset button.	Press the button, the backrest angle will automatically move to the maximum, the cushion angle will automatically move to the maximum, the height of the bed will automatically reach the lowest position.

Optional configuration (Instruction of Hand Controller)

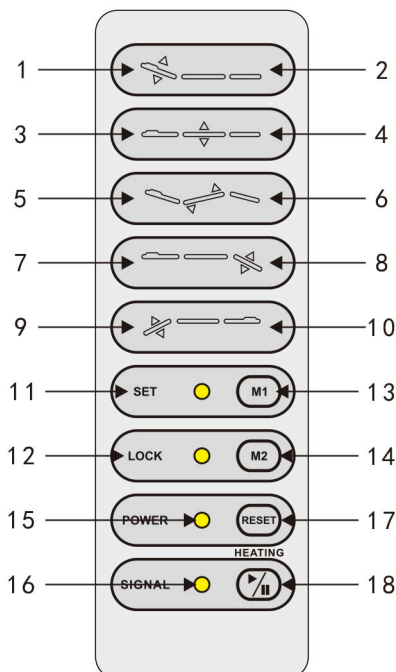

Optional configuration (Foot Controller)

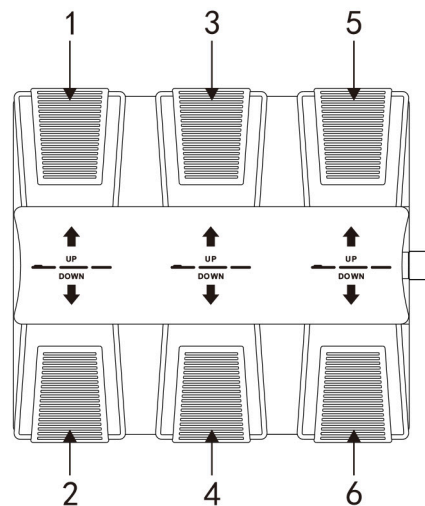

	Description	Operation
1	Backrest motor goes up	Backrest goes up smoothly by pressing the button.
2	Backrest motor goes down	Backrest goes down smoothly by pressing the button.
3	Whole bed motor goes up	The whole bed goes up smoothly by pressing the button.
4	Whole bed motor goes down	The whole bed goes down smoothly by pressing the button.
5	Cushion angle motor goes up	Angle of cushion increases smoothly by pressing the button.
6	Cushion angle motor goes down	Angle of cushion decreases smoothly by pressing the button.
7	The right leg pad motor goes up	Angle of right leg pad increases smoothly by pressing the button.
8	The right leg pad motor goes down	Angle of right leg pad decreases smoothly by pressing the button.
9	The left leg pad motor goes up	Angle of left leg pad increases smoothly by pressing the button.
10	The left leg pad motor goes down	Angle of left leg pad decreases smoothly by pressing the button.
11	Enter the memory location setting	The indicator light is on by pressing the button for 3 seconds, then enter the memory position setting state.
12	Button lock indication	The indicator light is on by pressing the button for 3 seconds, all the buttons are locked; The indicator goes off by long pressing the button for 3 seconds, all the buttons are unlocked.
13	Memory position setting 1	1. After entering the memory position setting state, the memory position setting indicator is on. Setting through the action which you need, and pressing the button, the actions are set into memory. Exiting the memory position setting state and the indicator goes off. 2. Press the button to move to the memory action state automatically
14	Memory position setting 2	1. After entering the memory position setting state, the memory position setting indicator is on. Setting through the action which you need, and pressing the button, the actions are set into memory. Exiting the memory position setting state and the indicator goes off. 2. Press the button to move to the memory action state automatically
15	Power indicator	Hand controller are connected with power supply properly, indicator light is on. Otherwise, it does not light.
16	Heating function indication (optional)	Pressing the button, the heating function works; press the button again, the heating function stops.
17	Motor reset	Press the button, the backrest angle will automatically move to the maximum, the cushion angle will automatically move to the maximum, leg pad angle will automatically reduce to the minimum, the height of the bed will automatically reach the lowest position.
18	Heating (optional)	Pressing the button, the heating function works; press the button again, the heating function stops.


Notes:

The memory position setting is only available for the models with memory function.

The heating function is only available for the models with heating function.


7. TECHNICAL PARAMETERS

Product size	1860 (L) × 860 (W) × 580 (880) (H) mm
Package size	1360×820×640mm
The highest position	880±10mm
The lowest position	580±10mm
Angle adjustment of the backrest	0° ~+80°
Angle adjustment of the seat cushion	0° ~+10°
Rotation angle of left and right	-120° ~+120°
Angle adjustment of the footrest	-90° ~ 0°
Length adjustment of the footrest	150mm
Net weight	79 kg
Gross weight	92 kg
Power	AC 220~240V, 50Hz/60Hz
Maximum power	300W
Environment temperature	0°C~+40°C
Relative humidity	30%~90%
Lifting rated load	170 kg

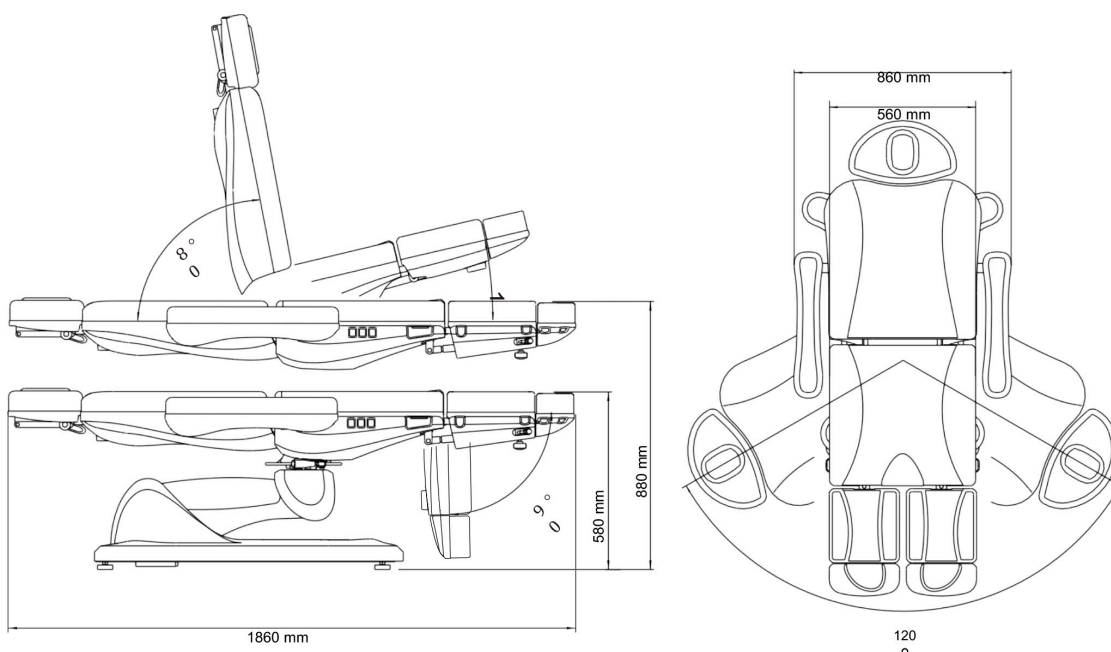

8. CIRCUIT SYSTEM CONNECTION DIAGRAM

AC 100-120V ,50Hz/60Hz OR AC 220-240V,50Hz/60Hz

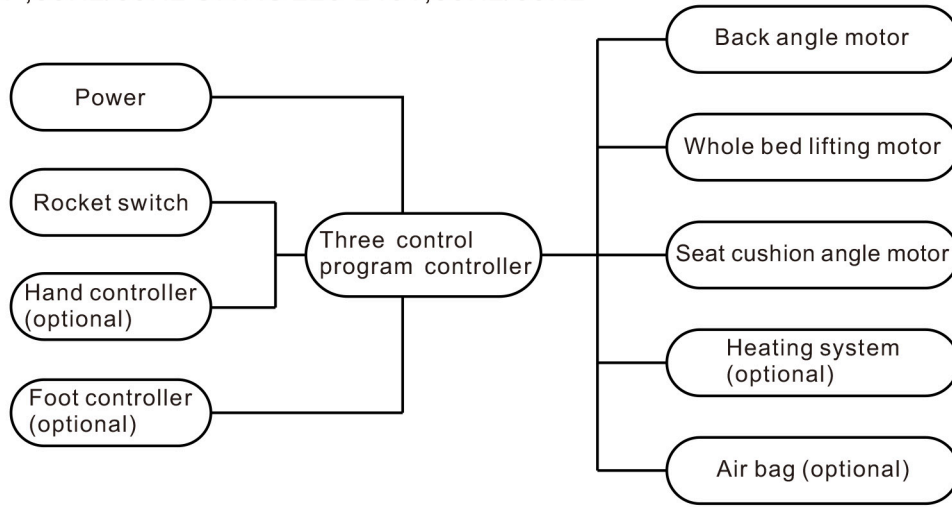

9. TROUBLESHOOTING


The fault phenomenon	Reason	Solution
Can't go up or down normally	1. The power cord is unconnected or not plugged well	1. Connect the power cord or plug it well
	2. Poor quality of the manual controller	2. Replace the manual control panel
	3. Poor quality of the foot control switch	3. If problem is still not solved after replacing the manual controller or foot control switch, please contact maintenance center or supplier to clear the trouble.
	4. Poor quality of the controller box	
	5. Rupture of motor tail	
	6. Motor detonation	
	7. When reset function not working	1. If there is a sound "Di" but not working after pressing the reset button, please loose the footrest extension, close it totally again and lock it tightly. Then try again the reset function. 2. If not working and no sound "Di" after pressing the reset button, please open the plastic covers of footrest and backrest separately to check whether the power line terminals inside are loose. If yes, please connect them and try again the reset function. 3. If problem still exists after the above operations, please contact maintenance center or supplier to troubleshoot the problem.
Abnormal sound	1. The rotating parts lack of lubricating oil	1. Add lubricating oil
	2. Rotating position (such as hinge, P, O, M sets) Lack of lubricating oil	2. Add lubricating oil
	3. Motor quality problems	3. Replace the motor

10. MAINTENANCE

After every treatment, please use neutral reagent to clear the dust, stains on leather or the plastic cover. This is to prevent premature aging of the leather and plastic cover,

Instruction for Tightening the Braking Block of 2246 series

(This is to tighten the braking block which the gear is frayed.)

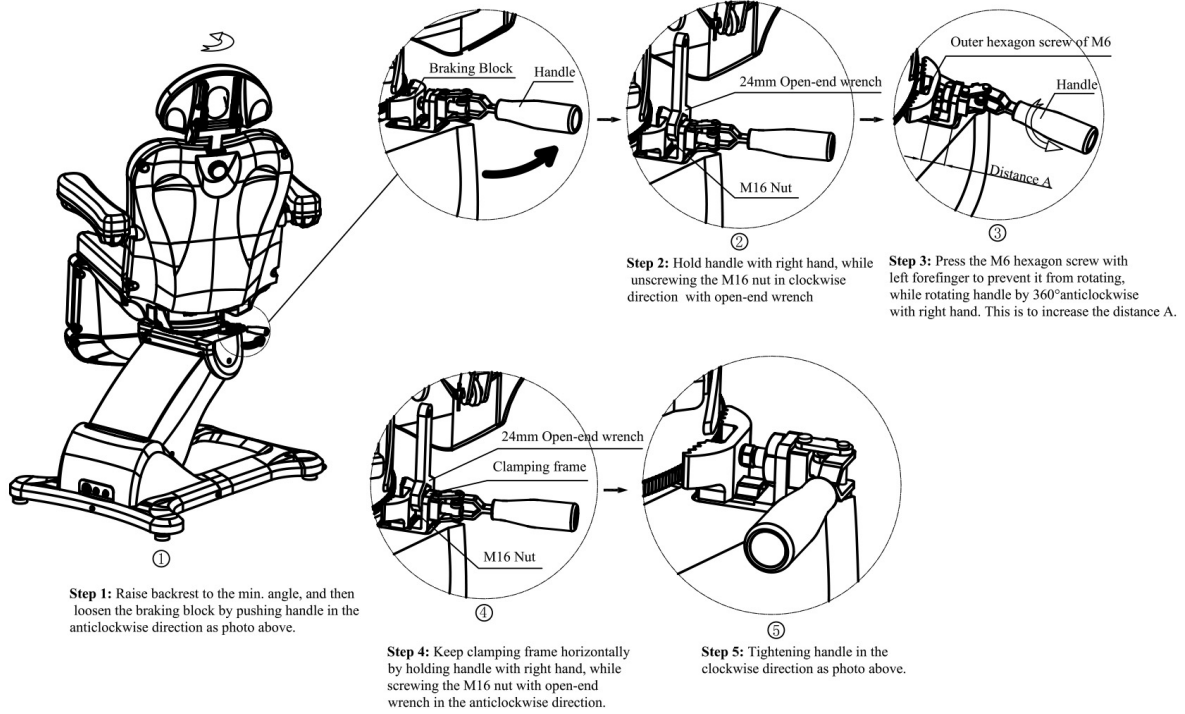

Instruction for Replacing Braking Block of 2246 series

(This is to replace the braking block if the gear of braking block is absolutely worn out and it doesn't work any more.)

