JELCO

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™

(Straight)

pt INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CE 0086

CCN. 004/008/015 REV. 001 06/12

Manufacturer:
Smiths Medical International Ltd.
St. Crispin Way, Haslingden,
Rossendale, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Tel: +44 (0)1706 233800

Distributed by:
Smiths Medical ASD, Inc.
201 West Queen St,
Southington, CT 06489, USA.
Tel: +1 860 621 9111

Australian Representative:
Smiths Medical Australasia Pty. Ltd.
61 Brandl Street, Eight Mile Plains,
Brisbane, QLD 4113, Australia.
Tel: +61 (0)7 3340 1300

www.smiths-medical.com

smiths medical

pt Português

	Aviso
	Não reutilizar
STERILIZE	Não reesterilizar
REF	Número de catálogo
LOT	Código de série
	Data de fabrico
	Utilizar até
	Fabricante
LATEX	Não contém látex de borracha natural
	Quantidade
STERILE EO	Esterilizado utilizando óxido de etileno
	Componentes da via de passagem do fluido apirogénicos
	Limites de temperatura
	Este lado para cima
	Frágil, manusear com cuidado
	Componentes da via de passagem do fluido apirogénicos
	Manter seco
	Manter afastado da luz solar

pt

Utilização única.
Não reutilizar: É necessário que determinadas características do material de dispositivos médicos tenham o desempenho pretendido. Estas características foram validadas para uma utilização única. Qualquer tentativa de reprocessar o dispositivo para subsequente reutilização pode afectar adversamente a integridade do dispositivo ou levar à alteração do seu desempenho.
Esterilizado enquanto a embalagem não for aberta ou danificada.
Destruir após utilização única.
Não reutilizar

Português pt

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™

(recto)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estas instruções são aplicáveis aos seguintes produtos Jelco®:

7130 a 7138 e 7188	*Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP*	*14 G a 24 G*
7260 a 7269 e 7288	*Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR*	*14 G a 24 G*

Estas instruções contêm informações importantes para a utilização segura do produto. Leia na íntegra o conteúdo destas instruções de utilização, incluindo as advertências e as precauções, antes de utilizar este produto.
Se as advertências, precauções e instruções não forem devidamente seguidas poderá resultar na morte ou em lesões graves do doente e/ou do médico.

NOTA: DISTRIBUIR ESTE FOLHETO INFORMATIVO A TODOS OS LOCAIS ONDE O PRODUTO SEJA COMERCIALIZADO.

1. DESCRIÇÃO:
Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consiste numa agulha introdutora e num protector integral da ponta da agulha. Os principais componentes são: *(1)* bisel da agulha, *(2)* agulha, *(3)* cateter, *(4)* conector do cateter, *(5)* protector da ponta, *(6)* câmara "flash", *(7)* conjunto de tampão "flash", *(8)* bainha, *(9)* estrutura do conector da agulha.

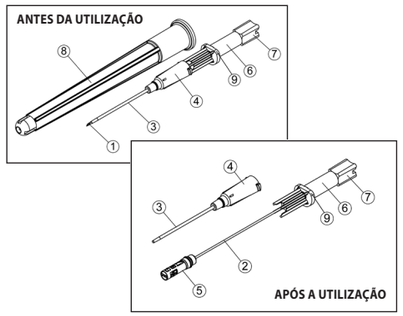

CALIBRE DO CATETER E TABELA DE REFERÊNCIA

Calibre	14G	16G	18G	20G	22G	24G
Cor	Laranja	Cinzento	Verde	Cor-de-rosa	Azul	Amarelo

Este dispositivo destina-se exclusivamente a uma única utilização e é fornecido estéril e apirogénico. Os materiais utilizados no fabrico deste cateter IV radiopaco não contêm látex nem PVC e DEHP.

2. INDICAÇÕES:
2.1 Um Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ correctamente colocado permite o acesso a uma veia ou artéria para colheita de sangue, monitorização da pressão ou administração de fluidos.
2.2 O protector da ponta que fica bloqueado sobre a agulha, à medida que esta é retirada, ajuda a reduzir o risco de picadas de agulha acidentais.
2.3 Estes cateteres podem ser utilizados em qualquer população de doentes devendo ser considerada a estatura do doente, a adequação da solução para perfusão e a duração da terapêutica.
2.4 Cateteres de calibre 14 a 24 podem ser utilizados com injectores eléctricos com pressão máxima de 300 psi.

3. CONTRA-INDICAÇÕES:
Não são conhecidas.

4. ADVERTÊNCIAS:
4.1 Para utilização correcta, OS MÉDICOS TÊM DE ESTAR TREINADOS NA PRÁTICA DE PUNÇÃO VENOSA e seguir as instruções de utilização. O não cumprimento destas instruções poderá resultar na morte ou em lesões graves do doente e/ou do médico.
4.2 Para evitar a possibilidade de êmbolo:
- **NÃO CORTE O CATETER nem utilize instrumentos cortantes próximo do cateter.**
- **Nunca reinsira a agulha introdutora dentro do cateter, pois poderá cortá-lo.**

4.3 Para evitar a possibilidade de picada de agulha acidental:
- **NÃO DOBRE A AGULHA durante a inserção, a progressão ou a remoção do conjunto de cateter.**
- **Se a punção venosa não for bem sucedida, engate o mecanismo de segurança e elimine a agulha e o cateter.**
- **Na hipótese improvável de o dispositivo não ficar bloqueado, elimine imediatamente o objecto cortante para um recipiente de cortantes aprovado.**

4.4 A agulha não se destina a ser utilizada como um fio-guia - a sua utilização impedirá a activação do protector da ponta de segurança.
4.5 Não manipule o conjunto de protector da ponta antes ou depois da utilização.

5. AVISOS:
5.1 O produto encontra-se estéril e é não tóxico e apirogénico, excepto se a embalagem estiver aberta, molhada ou danificada. Elimine se alguma destas situações se verificar.
5.2 Deve estabelecer a permeabilidade antes da utilização com injectores eléctricos. A utilização de um injector eléctrico com pressão superior a 300 psi pode originar fuga e/ou danos no produto. Não dobre nem obstrua o cateter durante a utilização de um injector eléctrico. Certifique-se de que o injector está devidamente calibrado e que parará automaticamente numa pressão acima de 300 psi.

6. PRECAUÇÕES:
6.1 Este dispositivo foi concebido para ajudar a reduzir o risco de picadas de agulha acidentais. Além destas instruções de utilização, recomenda-se que o profissional de saúde siga as recomendações estabelecidas pelas normas dos CDC e OSHA (EUA) ou equivalentes locais relativas a agentes patogénicos transmitidos pelo sangue ao iniciar, manter ou eliminar qualquer cateter IV para evitar o risco de exposição a sangue.
6.2 Siga as actuais políticas e procedimentos institucionais relativos à inserção, manutenção e remoção do cateter.
6.3 O cateter é mais curto do que a agulha introdutora. Por este motivo, poderá ocorrer fluxo retrógrado de sangue antes de a ponta do cateter estar totalmente dentro do vaso sanguíneo. Se necessário, faça o cateter e a agulha avançarem ligeiramente em conjunto para garantir a total entrada do cateter no lúmen do vaso sanguíneo. Para evitar a punção acidental da parede posterior do vaso, baixe a agulha até que fique paralela à pele.
6.4 Certifique-se de que a ligação de administração de fluido/conector está bem fixa para evitar fugas.
6.5 Garanta a estabilização do cateter no doente. A estabilização incorrecta pode levar à perda de acesso vascular.

7. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Devido ao risco de exposição a agentes patogénicos transmitidos pelo sangue, siga precauções padrão durante a colocação, a utilização e a remoção de um cateter IV
7.1 Seleccione e prepare o local de acordo com a política institucional. Aplique o garrote.
7.2 Retire a bainha para fora a direito e inspeccione o dispositivo. Certifique-se de que o conector do cateter codificado por cores está totalmente encaixado e verifique se o bisel da agulha está para cima.
7.3 Segure o dispositivo pela câmara "flash" transparente cilíndrica. Verifique se a secção plana da estrutura do conector da agulha e o bisel da agulha estão orientados para cima.
7.4 Fixe o vaso sanguíneo com uma ligeira tracção da pele e insira a agulha na pele e no vaso sanguíneo, no ângulo adequado.
7.5 O refluxo de sangue para a câmara "flash" confirma a entrada no vaso sanguíneo.
7.6 Diminua o ângulo e insira ligeiramente o dispositivo para assegurar a entrada do cateter no vaso sanguíneo.
7.7 Retire o garrote.
7.8 Antes de retirar a agulha, pressione o vaso sanguíneo com os dedos, distalmente à ponta do cateter, e fixe o conector do cateter; depois, retire a agulha puxando a direito. O protector da ponta encaixar-se-á automaticamente sobre a ponta da agulha.
Nota: verificar-se-á uma ligeira resistência à medida que a agulha protegida for retirada do conector do cateter.
7.9 <u>Nota</u>: não volte a inserir o protector da ponta no conector depois de ter sido removido.
7.10 Ligue a linha de administração IV e coloque um penso de acordo com a política institucional.
7.11 Elimine imediatamente a unidade num recipiente de objectos cortantes descartável, estanque e resistente a perfurações.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, as marcas de desenho Jelco e Smiths Medical são marcas registadas da Smiths Medical. O símbolo ® indica que é uma marca registada na Repartição de Registo de Patentes dos E.U.A. e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionadas são nomes comerciais, marcas registadas ou marcas de serviço dos respectivos proprietários. Não há qualquer ligação entre a Smiths Medical e a Intuitive Surgical. © 2012 Smiths Medical. Todos os direitos reservados.