


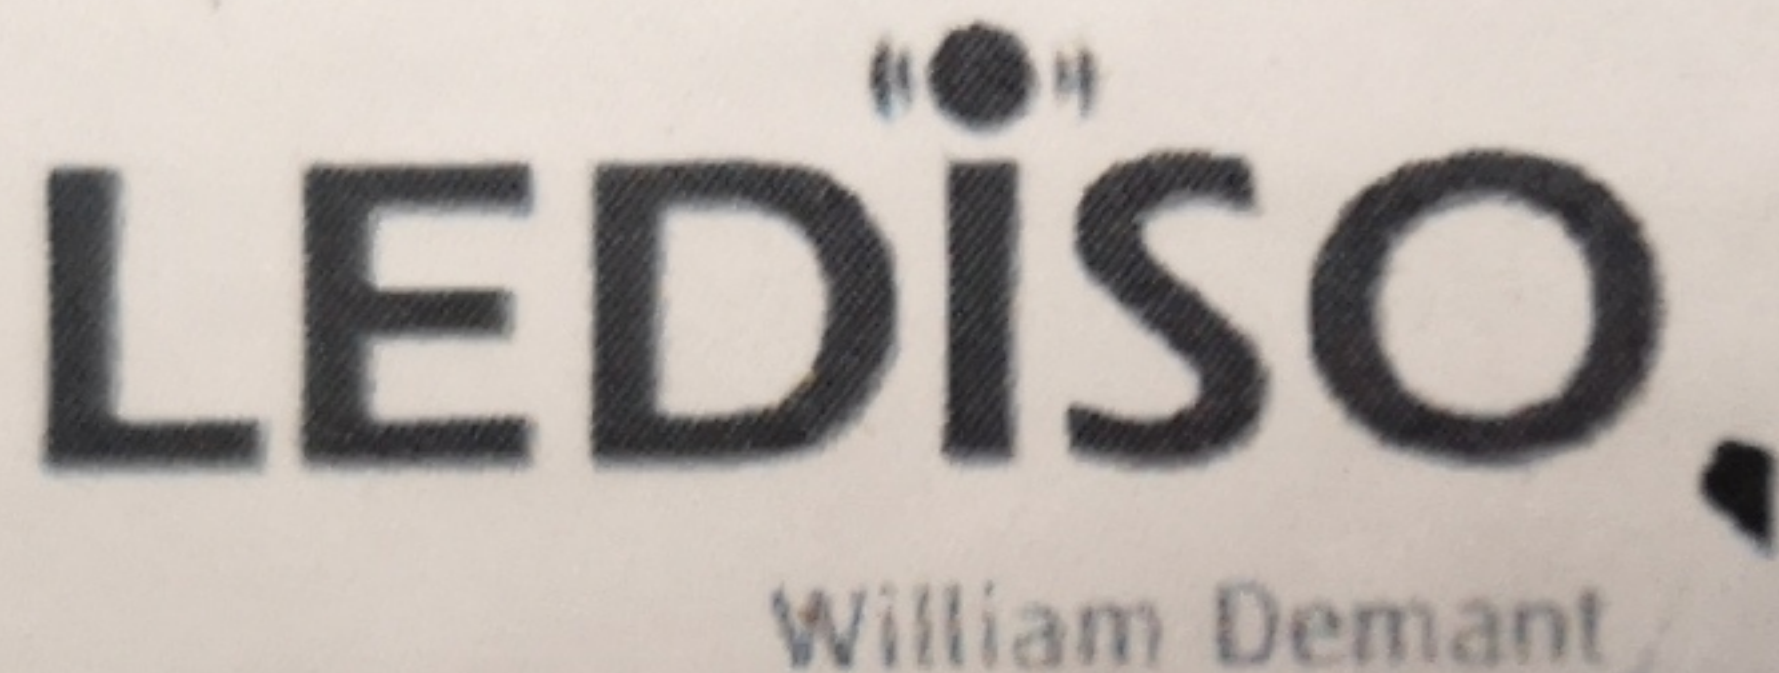

Telefono: 055 4288392

Fax: 055 3265213

E-mail: [laboratorio@lediso.it](mailto:laboratorio@lediso.it)

Web: [www.lediso.it](http://www.lediso.it)

Modello strumento:

240

Numero di serie:

32228

Calibrazione consigliata:

SETTEMBRE 2018



**Amplivox Ltd**

**Audiometer**

**2017**



**+ 5V DC**

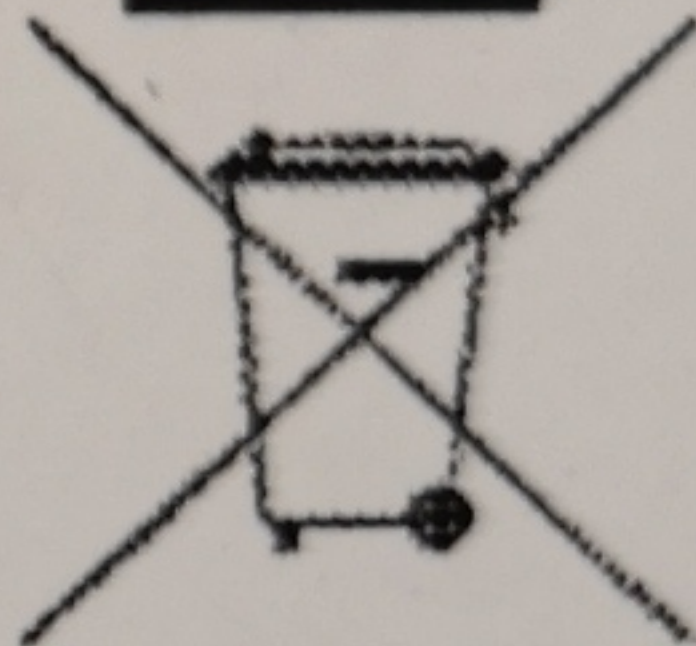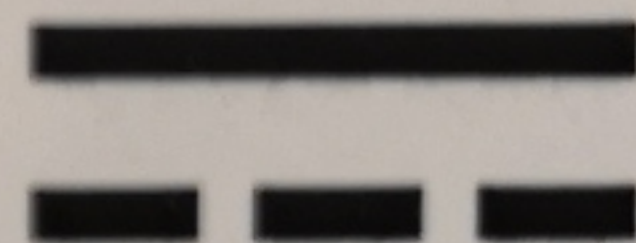

**CE 0473**

**Serial No:**

**32228**

